
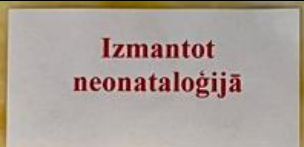


APSTIPRINU	Valsts asinsdonoru centra direktore	E.Pole	(personiskais paraksts*)	23.12.2022
------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	------------

Produkta nosaukums	Produkta kods
Krioprecipitāts	E3575

Parametrs	Prasība
Laboratoriskie izmeklējumi:	
ABO piederība	Identificēta
HIV AV+Ag	Negatīvs
HCV AV	Negatīvs
HBs Ag	Negatīvs
T.Pallidum AV	Negatīvs
HCV RNS	Negatīvs
HIV RNS	Negatīvs
HBV DNS	Negatīvs
Antieritrocitārās antivielas	Negatīvs
Kvalitātes kontroles rādītāji	Atbilst "Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components" (aktuālā versija) prasībām
Makroskopiskās novērtēšanas kritēriji	Maisam ar krioprecipitātu nav redzamas bojājuma pazīmes, pēc atkausēšanas maiss ar krioprecipitātu ir hermētisks Krioprecipitāta krāsa ir atbilstoša (dzidra, nav duļķaina, nav pārslojuma) Krioprecipitāta deva ir identificējama
Fināla etiķete	Atbilst ISBT 128 standartam (sk. 1.att.)
<u>Izmantošanai jaundzimušajiem un bērniem līdz 4 mēnešu vecumam</u>	

Uzglabāšanas temperatūra	Transportēšanas temperatūra
<-25°C	<-25°C (ja transportēšanas laikā temperatūra sasniedz -18°C, tad krioprecipitāta derīguma termiņš jānomaina uz 3 mēnešiem)

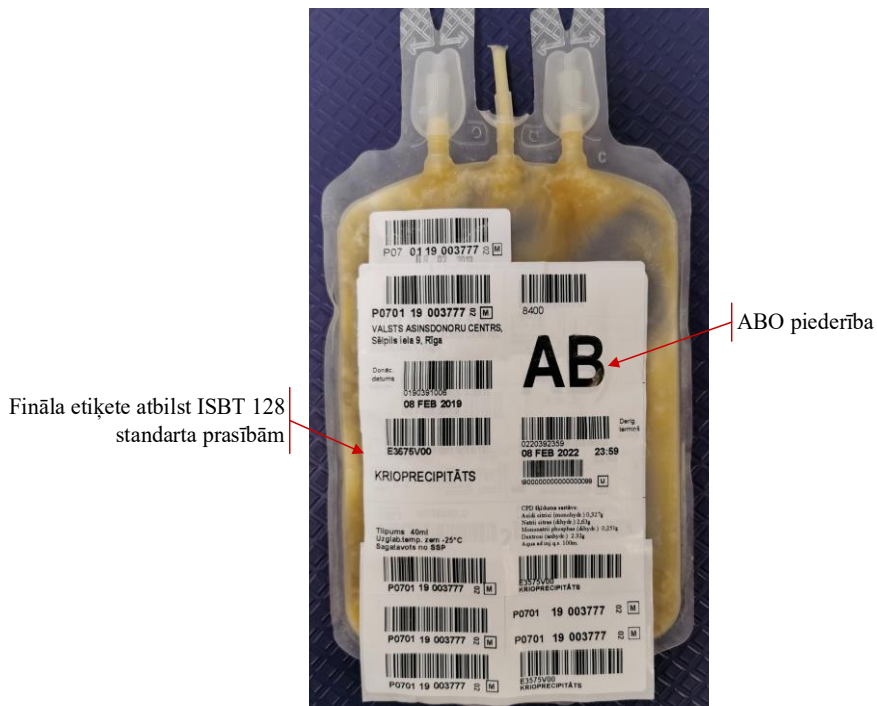

1.att. Pārļiešanai derīgas krioprecipitāta devas piemērs

Izstrādāja:

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Transfuzioloģiskā departamenta direktore	N.Kanta	(personiskais paraksts*)	23.12.2022

Saskaņoja:

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Kvalitātes un risku vadības departamenta Eksperts Asins dienestā	E.Kluce	(personiskais paraksts*)	23.12.2022